


## Доступный газоанализ для ферментации

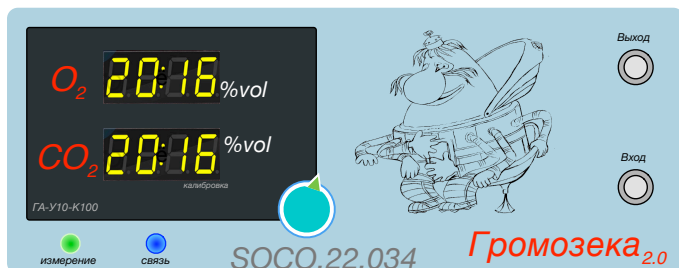


### Концентрация CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>


- Диапазон O<sub>2</sub>: 0-100 %объём
- Диапазон CO<sub>2</sub>: 0-100 %объём
- Точность: <2%FS
- Среда: 0-99 %RH, -10 – 50 °C

### Хранение, связь и управление

- связь устройств
- хранение данных измерений
- комплексное управление
- до 255 устройств

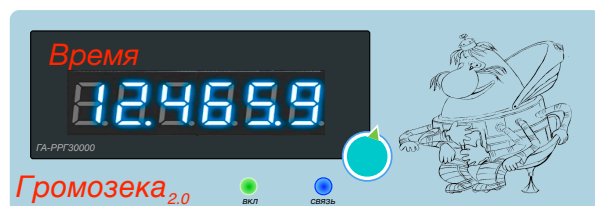

### Концентрация CH<sub>4</sub>

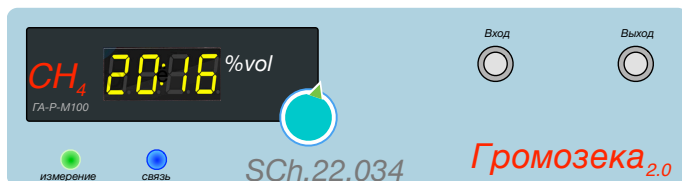


- Диапазон: 0-100 %объём
- Точность: 0,01%объём
- Среда: 0-99 %RH, -40 – 70 °C

### Расходомер




- Диапазон: 0-1/2/30 л/мин
- Точность: <3%FS
- Среда: 0-99 %RH, -25 – 65 °C

### Переключение каналов

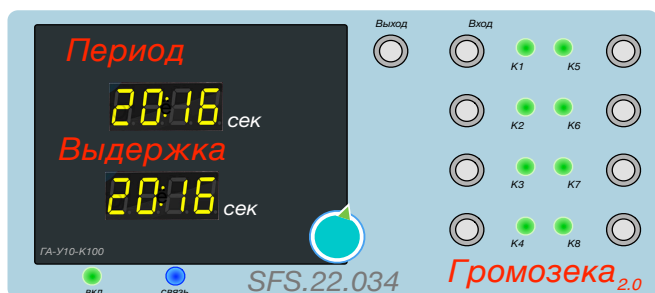

- 8 каналов
- Независимое включение
- Среда: 0-99 %RH, -25 – 65 °C

### Электронный регулятор расхода

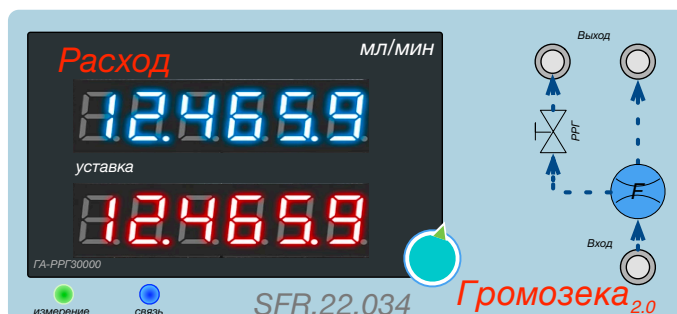

- Диапазон: 0-1/2/30 л/мин
- Точность: <3%FS
- Среда: 0-99 %RH, -25 – 65 °C